

Korte handleiding voor SNAP™-test

Inhoudsopgave

SNAP™-testkits in een oogopslag 3

SNAP Pro™-analyzer 4

SNAP™ 4Dx™ Plus-test 5

SNAP™ FIV/FeLV-combotest 6

SNAP* Feline Triple*-test 7

SNAP™ cPL-test 8

SNAP™ fPL-test 9

SNAP™-test voor het parvovirus 10

SNAP™ -test voor *Giardia* 11

SNAP™-test voor proBNP bij katten 12

SNAP™-test voor leptospirose 13

SNAP™-test voor FeLV-antigeen 14

SNAP™ IgG-test voor veulens 15

SNAP™-test voor *Leishmania* 16

SNAP™ Leish 4Dx™-test 17

Angio Detect™-test 18

Markering

Ondersteunde diersoorten.

8 min. Leestijd in minuten.

Bewaren bij kamertemperatuur of in de koelkast.

Bewaren in de koelkast.

ALLE onderdelen moeten op kamertemperatuur zijn voordat de test wordt uitgevoerd.

SNAP™-testkits in een oogopslag

Testnaam†	Ondersteunde monstertypen				Opslag* Gekoeld = 2 °C-8 °C Kamertemperatuur = 2 °C-25 °C	Grootte van monster	Druppels van oplossing	Leestijd (minuten)
	Fecaal	Volbloed met anticoagulans	Plasma	Serum				
SNAP™ 4Dx™ Plus-test		•	•	•	Bij kamertemperatuur gedurende maximaal 6 maanden of gekoeld tot het einde van de houdbaarheid	3 druppels	4	8
SNAP™ FIV/FeLV-combotest		•	•	•	Gekoeld tot einde houdbaarheid	3 druppels	4	10
SNAP Feline Triple-test		•	•	•		3 druppels	4	10
SNAP™ cPL-test				•		3 druppels	4	10
SNAP™ fPL-test				•		3 druppels	4	10
SNAP™-test voor het parvovirus	•				Bij kamertemperatuur tot einde houdbaarheid	Bedek de volledige punt van het wattenstaafje met een dun laagje fecaal materiaal.	5	8
SNAP™ *-test voor* Giardia	•				Gekoeld tot einde houdbaarheid	Bedek de volledige punt van het wattenstaafje met een dun laagje fecaal materiaal.	5	8
SNAP™-test voor proBNP bij katten			•	•		3 druppels	5	10
SNAP™-test voor Leptospirose				•		3 druppels	4	10
SNAP™-test voor FeLV-antigeen		•	•	•		3 druppels	4	10
SNAP™ IgG-test voor veulens		•	•	•		1 druppel	De volledige fles of totdat de opening vol is	7
SNAP™-test voor *Leishmania*		•	•	•	Bij kamertemperatuur gedurende maximaal 6 maanden of gekoeld tot het einde van de houdbaarheid	3 druppels	4	8
SNAP™ Leish 4Dx™-test		•	•	•		3 druppels	4	8
Angio Detect-test			•	•	Bij kamertemperatuur tot einde houdbaarheid	3 druppels	3 druppels	15

*Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige opslagvereisten.
†Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

SNAP Pro™-analyzer

BELANGRIJK: Bereid de SNAP-test voor, maar activeer de test nog niet.*

Wanneer dit wordt aangegeven door de SNAP Pro, schuift u de SNAP-test voorzichtig in de poort onderaan de analyzer (met de kant van de opening eerst) totdat deze vastklikt.



Juist



Onjuist



Continu groen
Alle resultaten zijn negatief.



Knipperend blauw
Ten minste één resultaat is positief.



Knipperend geel
Visuele controle vereist.
(Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer informatie.)

De betekenis van SNAP Pro-pictogrammen

Pictogram	Betekenis
	Status van het draadloze signaal (wifi) (5 grijze balkjes: beste signaal, 5 rode balkjes: geen signaal)
	Wifiverbinding verbroken
	Gekoppeld aan het IDEXX VetLab™ Station via een bekabelde verbinding en er vindt communicatie plaats (een rood pictogram duidt aan dat de analyzer offline is)
	Ethernetverbinding verbroken
	Batterijen worden opgeladen


Pictogram	Betekenis
	Er is een software-upgrade beschikbaar (alleen voor klanten van SmartService™-oplossingen)
	Waarschuwingsmelding (een grijs pictogram geeft aan dat de waarschuwing is gezien, maar nog niet is verholpen)
	Foutmelding (een grijs pictogram geeft aan dat de fout is gezien, maar nog niet is verholpen)
	Communicatie met IDEXX VetLab Station verbroken

Ga voor meer informatie of om dit product te bestellen naar **idexx.co.uk/prohelp**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.


SNAP™ 4Dx™ Plus-test

Screen honden op zes ziekteverwekkende pathogenen die door vectoren worden overgedragen.

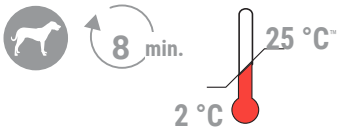

Kan gedurende 6 maanden bij kamertemperatuur worden bewaard.*

Testprocedure†



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP 4Dx Plus-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **8 minuten** af.

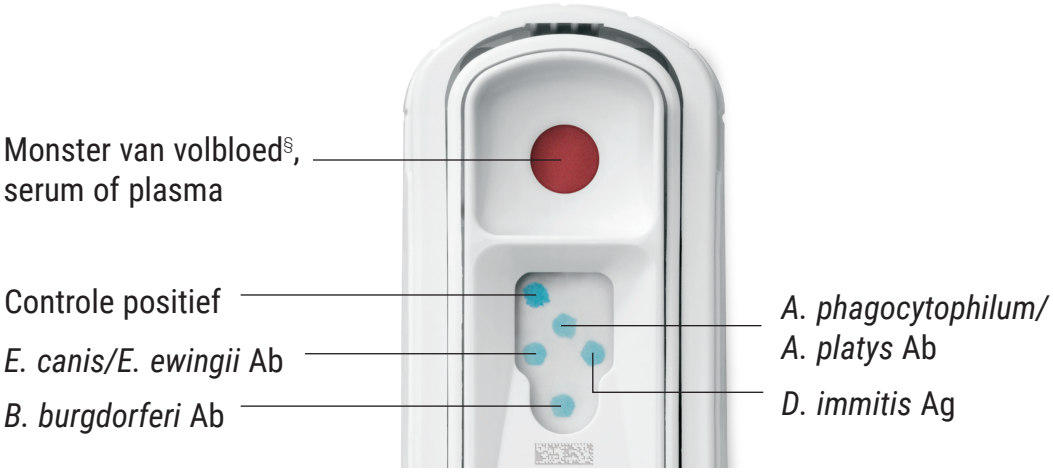


Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snap4dxplus**.


*De houdbaarheid van de tests bedraagt 6 maanden bij bewaring op kamertemperatuur. Als de testen niet bij kamertemperatuur worden bewaard, kunnen ze tot het einde van de houdbaarheid gekoeld worden bewaard. Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige opslagvereisten.
†Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
§Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine).

SNAP™ FIV/FeLV-combotest

Test alle katten die nieuw zijn in het huishouden, risicokatten en katten met symptomen op het feliene immunodeficiëntievirus (FIV) en het feliene leukemievirus (FeLV).

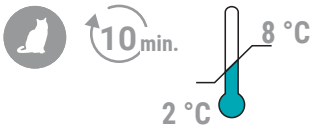

Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP FIV/FeLV-combotest.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

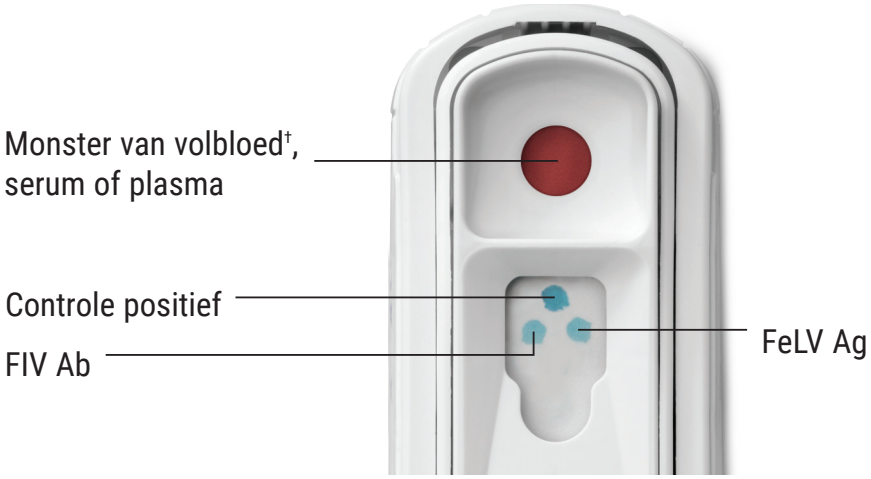

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snapcombo**.


*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine)

SNAP* Feline Triple*-test

Test alle katten die nieuw zijn in het huishouden, zieke katten, risicokatten en katten met luchtweg- of braaksymptomen op het feliene immunodeficiëntievirus (FIV), het feliene leukemievirus (FeLV) en hartworm bij katten.



Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP Feline Triple-test.



4. Use the SNAP Pro®-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

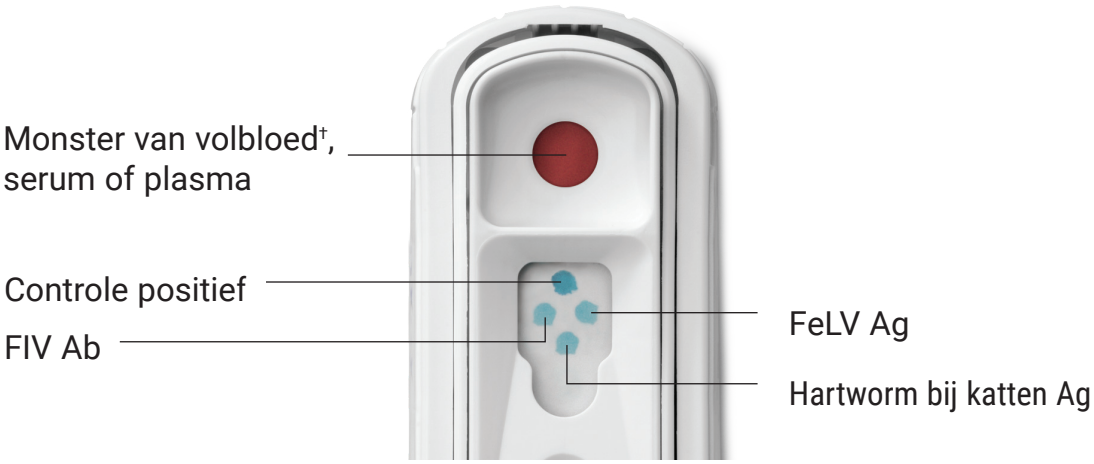

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.order.uk of www.idexx.co.uk**.


*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine)

SNAP™ cPL-test

Test honden die braken, verminderde eetlust en/of buikpijn hebben.



Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.




2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP cPL-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
   OF
   Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

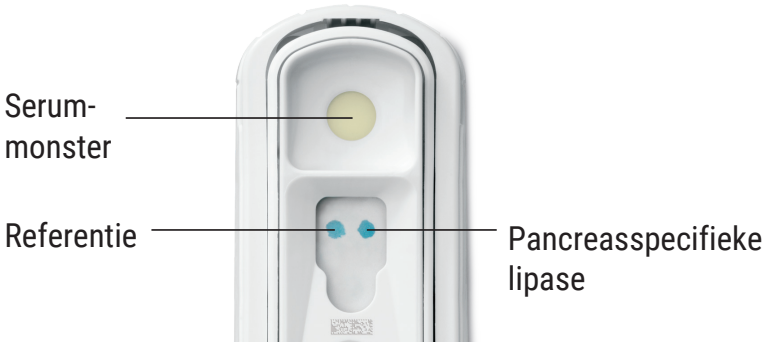

Abnormaal
De monsterstip heeft dezelfde kleur als of een donkerdere kleur dan de referentiestip.




Normaal
De monsterstip is lichter van kleur dan de referentiestip.

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snapcpl**.


*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

SNAP™ fPL-test

Test katten met lusteloosheid, verminderde eetlust, uitdroging, gewichtsverlies, die braken en/of diarree.

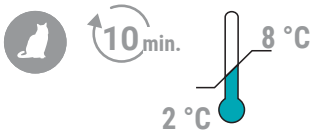

Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.




2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP fPL-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

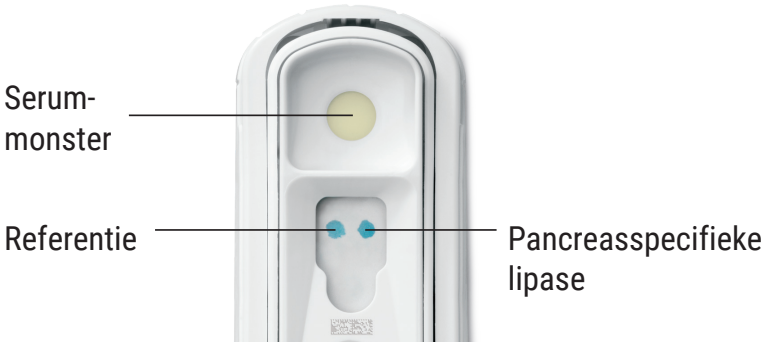

Abnormaal
De monsterstip heeft dezelfde kleur als of een donkerdere kleur dan de referentiestip.




Normaal
De monsterstip is lichter van kleur dan de referentiestip.

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snapfpl**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

SNAP™-test voor het parvovirus

Test honden die plotselinge lusteloosheid vertonen, braken, koorts hebben en diarree hebben.

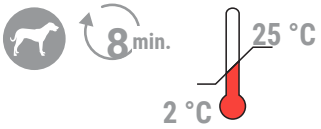

Kan worden bewaard bij kamertemperatuur.*

Testprocedure†



1. Neem een monster af met een wattenstaafje‡ en plaats de punt van het wattenstaafje in het buisje. Buig het bovenste deel om de verzegeling te verbreken en het conjugaat vrij te laten komen.



2. Knijp **3 keer** in het bovenste deel en laat het los om het monster en het conjugaat te mengen.




3. Knijp in het bovenste deel om **5 druppels** in de monsteropening van een SNAP Parvo-test aan te brengen.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **8 minuten** af.

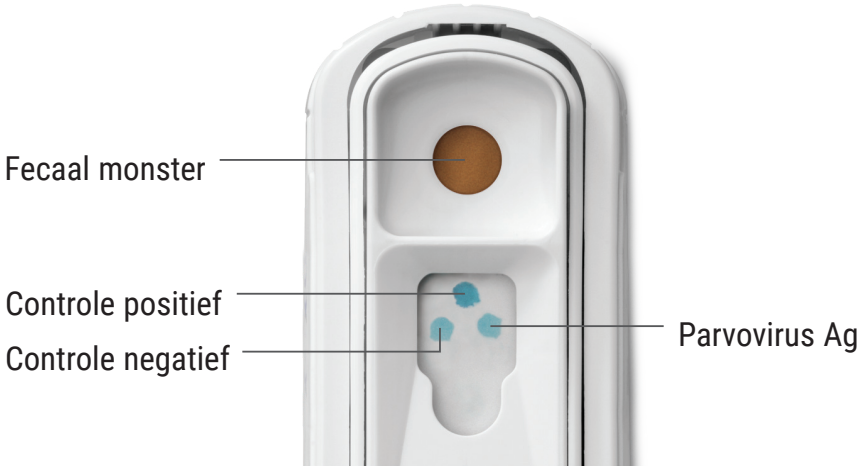

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/parvo**.

*Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige opslagvereisten.
†Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
‡De afnameswab is niet bedoeld voor rectaal gebruik.

SNAP™ -test voor *Giardia*

Test honden en katten met diarree.



Testprocedure*



1. Neem een monster af met een wattenstaafje† en plaats de punt van het wattenstaafje in het buisje. Buig het bovenste deel om de verzegeling te verbreken en het conjugaat vrij te laten komen.



2. Knijp **3 keer** in het bovenste deel en laat het los om het monster en het conjugaat te mengen.




3. Knijp in het bovenste deel om **5 druppels** in de monsteropening van een SNAP *Giardia*-test aan te brengen.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **8 minuten** af.

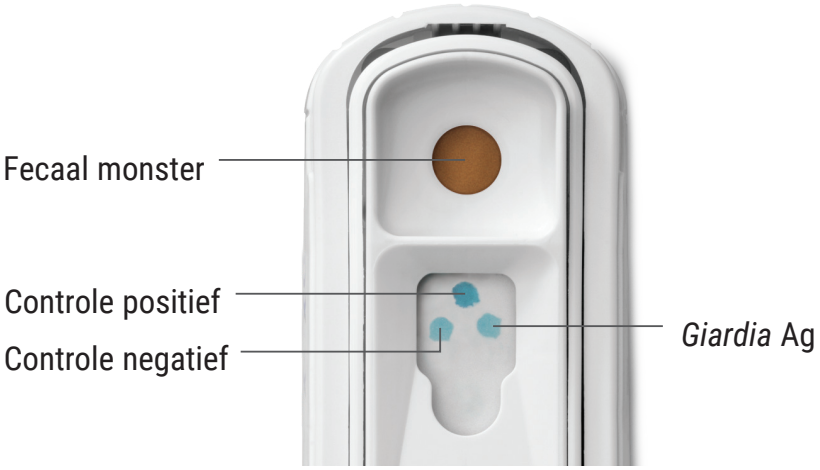

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/giardia**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†De afnameswab is niet bedoeld voor rectaal gebruik.

SNAP™-test voor proBNP bij katten

Test katten met een verhoogd risico op hartaandoeningen (hartruis, hartritmestoornissen, respiratoire symptomen, voorafgaand aan anesthesie, ras, voorgeschiedenis, leeftijd).



Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **5 druppels groen conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP Feline proBNP-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

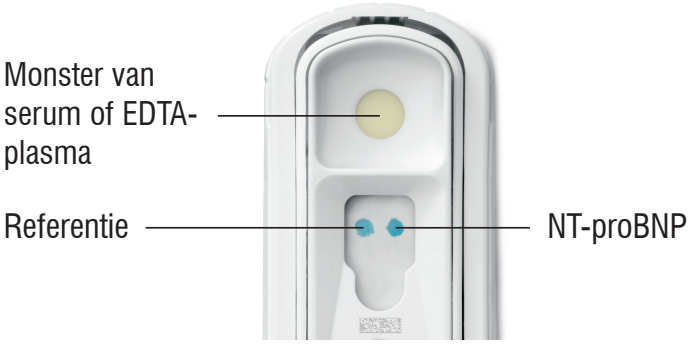

Abnormaal
De monsterstip heeft dezelfde kleur als of een donkerdere kleur dan de referentiestip.



Normaal
De monsterstip is lichter van kleur dan de referentiestip.

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snapprobnp**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

SNAP™-test voor leptospirose

Test honden wanneer er een vermoeden is van leptospirose.



Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP Lepto-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
OF
Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

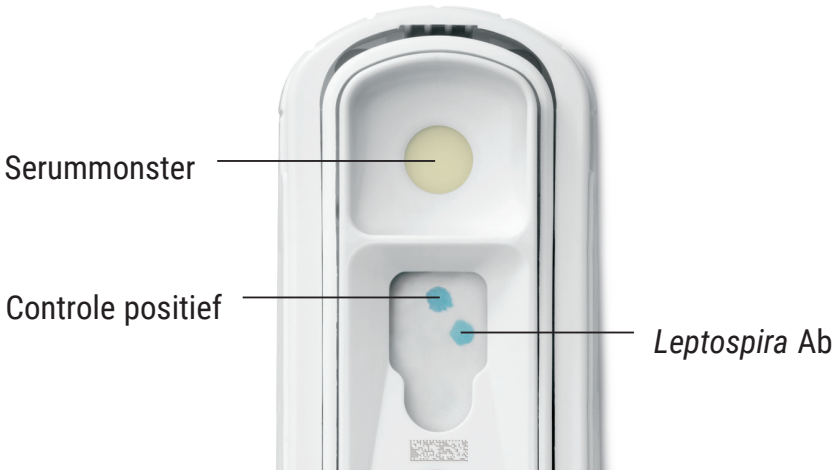

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snaplepto**.


*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

SNAP™-test voor FeLV-antigeen

Test katten op het feliene leukemievirus (FeLV).



Testprocedure*



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.



2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP FeLV Antigen-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
   OF
   Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **10 minuten** af.

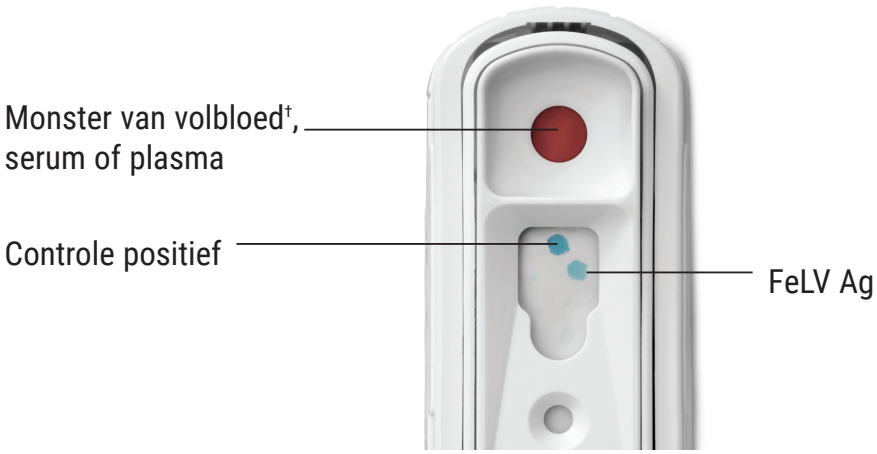

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/snapfelv**.


*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine)

SNAP™ IgG-test voor veulens


Test veulens op immunoglobuline G-spiegels (IgG).




Testprocedure*



1. Verdun het monster.† Meng grondig en gooi de eerste **5-10 druppels** uit het flesje weg.

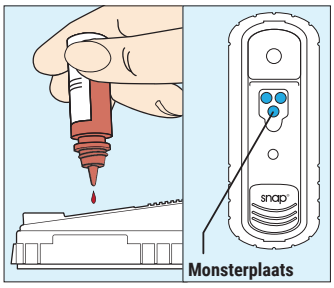

2. Breng **1 druppel** van het monster aan op de monsterstip.




3. Giet de volledige inhoud van het flesje met conjugaat in de monster-opening.




4. Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.




5. Lees het resultaat na **7 minuten** af.

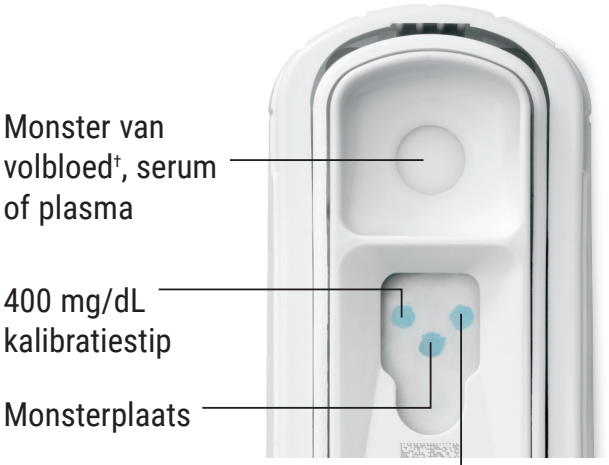




≤ 400 mg/dL IgG
De kleurintensiteit van de monsterstip is lichter dan van de 400 mg/dL kalibratiestip.



400-800 mg/dL IgG
De kleurintensiteit van de monsterstip is donkerder dan van de 400 mg/dL kalibratiestip of gelijk aan de 800 mg/dL kalibratiestip.



> 800 mg/dL IgG
De kleurintensiteit van de monsterstip is donkerder dan van de 800 mg/dL kalibratiestip.

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/foal**.

*™Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (bijvoorbeeld EDTA of heparine), monster van serum of plasma.


SNAP™-test voor *Leishmania*

Test honden wanneer er een vermoeden is van leishmaniose.




Kan gedurende 6 maanden bij kamertemperatuur worden bewaard.*

Testprocedure†



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.




2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP *Leishmania*-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
   OF
   Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **8 minuten** af.

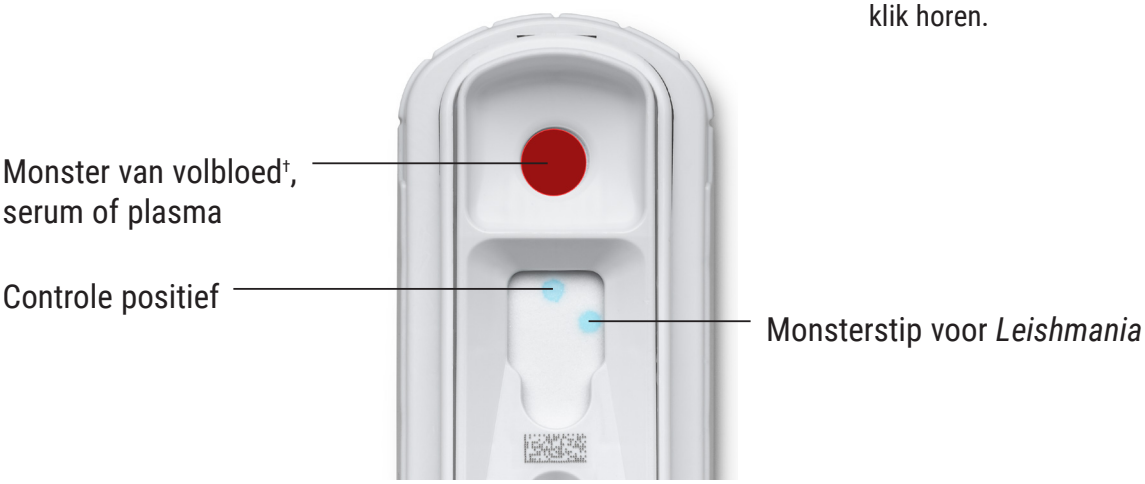

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.order.uk of www.idexx.co.uk**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine)


SNAP™ Leish 4Dx™-test

Screen honden op zes ziekteverwekkende pathogenen die door vectoren worden overgedragen.



Kan gedurende 6 maanden bij kamertemperatuur worden bewaard.*

Testprocedure†



1. Breng met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** en **4 druppels conjugaat** in het monsterbuisje.




2. Keer voorzichtig **3-5 keer om** om te mengen.




3. Giet de volledige inhoud van het monsterbuisje in de monsteropening van een SNAP Leish 4Dx-test.



4. Gebruik de SNAP Pro™-analyzer om de SNAP-test automatisch te activeren en het resultaat te interpreteren.
   OF
   Druk stevig om te activeren **zodra** de kleur in de activatiecirkel verschijnt. U zult een duidelijke klik horen.



5. Lees het resultaat na **8 minuten** af.

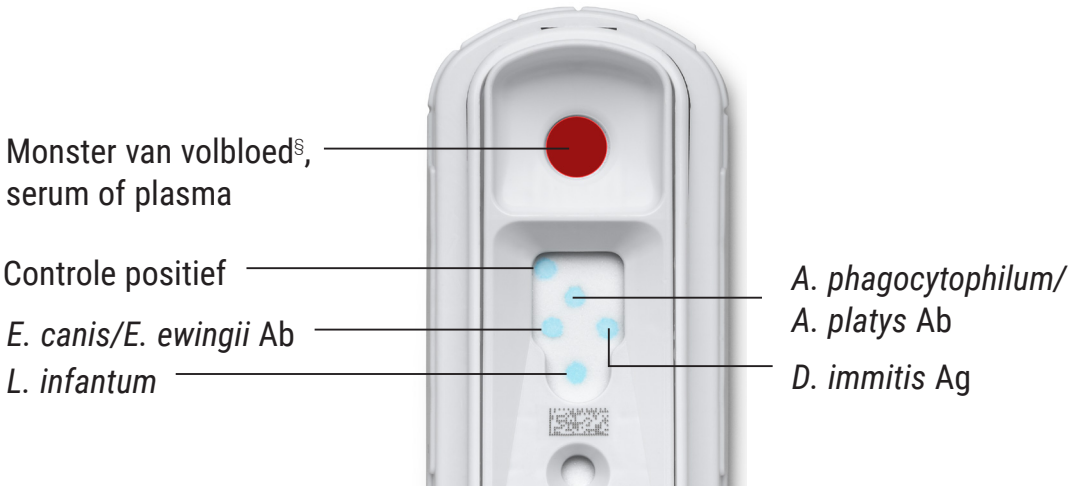


Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.co.uk/leish-4dx**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.
†Volbloed met anticoagulans (e.g., EDTA, heparine)


Angio Detect™-test

Detecteert antigenen van Angiostrongylus vasorum bij honden.

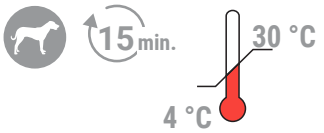


Bewaren in de koelkast is niet nodig.*


Testprocedure*




1. Breng met de meegeleverde pipet aan **3 druppels van het monster** in de monsteropening (S), totdat deze volledig zijn opgenomen.



2. Verwijder alleen de blauwe dop van het flesje met testbuffer en laat de witte dop stevig vastzitten. Houd vervolgens het bufferflesje verticaal en voeg **3 druppels buffer** toe aan de ronde monsteropening.



3. Lees het resultaat na **15 minuten** af.

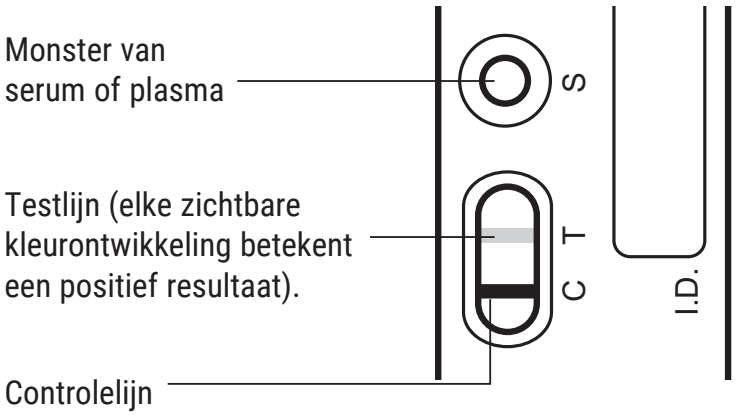

Ga voor meer informatie of om deze test te bestellen naar **idexx.order.uk of www.idexx.co.uk**.

*Raadpleeg vóór het uitvoeren van een test de bijsluiter voor de volledige instructies.

Hebt u vragen?

Neem contact op met de klantenservice en technische ondersteuning van IDEXX op **0203 7887 508**.

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Alle rechten voorbehouden. • 06-0042144-01
Alle ™/TM-handelsmerken zijn eigendom van IDEXX Laboratories, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.